



ОБЪЕКТИВЫ И ТУБУСЫ МИКРОСКОПОВ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ОБЪЕКТИВЫ И ТУБУСЫ МИКРОСКОПОВ

Присоединительные размеры

Objektives and body-tubes of the microscopes.
Attaching dimensions

ГОСТ
11200—75

ОКП 44 3592


Дата введения 01.01.77

1. Настоящий стандарт распространяется на объективы и тубусы биологических, металлографических и поляризационных микроскопов и устанавливает их присоединительные размеры.

Стандарт не распространяется на объективы и тубусы измерительных, стереоскопических и специальных (высокотемпературных, люминесцентных, контактных) микроскопов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Присоединительные размеры объективов с тубусами микроскопов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

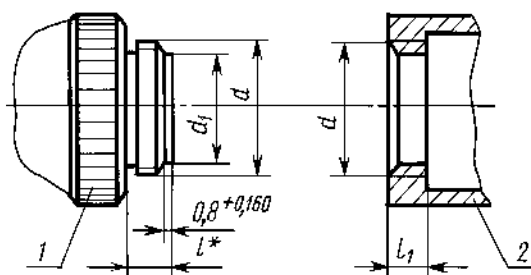

* Размеры для справок.

1 — объектив; 2 — тубус

Примечание. Чертеж конструкции узлов не определяет.

Размеры в мм

Номин.	d		d ₁		l*, не более	l ₁ , не менее
	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
	болта	гайки				
ОБ 4/5" × 1/36 по ГОСТ 3469	по ГОСТ 3469		19,0	−0,330	4,8	3,0
М27 × 0,75 по ГОСТ 9150	6g	6H	26,0			
М42 × 0,75 по ГОСТ 16967	6g	6H	41,0	−0,390	5,5	4,0
	по ГОСТ 16093					

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975
© ИПК Издательство стандартов, 2002