ГОСТ 9147—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ПОСУДА И ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2011

УДК 542.232 : 006.354 Группа П66

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПОСУДА И ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАРФОРОВЫЕ

Технические условия

ГОСТ 9147—80

Laboratory porcelain ware and apparatus.
Specifications

МКС 71.040.10
71.040.20
ОКП 43 2800

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на лабораторную фарфоровую посуду, предназначенную для проведения анализов: прямоугольные лодочки для определения зольности твердого топлива; лодочки для сжигания, предназначенные для прокаливания веществ при анализах; барабаны с крышками для шаровых мельниц, предназначенные для мокрого и сухого размола материалов минерального происхождения твердостью не выше 7 по шкале Мооса.

Стандарт распространяется на изделия, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на изделия, предназначенные для специальных исследований и учебных целей.

Стандарт соответствует ГОСТ 29225 в части технических требований к посуде.

Термины и их пояснения указаны в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные размеры и вместимость посуды должны соответствовать указанным на черт. 1—15 и в табл. 1—16.

Основные размеры и вместимость барабанов должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 17.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Лодочки должны изготовляться типов:

ЛЗ — лодочки прямоугольные для определения зольности;

ЛС — лодочки для сжигания.

1.3. Основные размеры лодочек должны соответствовать указанным на черт. 17, 18 и в табл. 18, 19.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1980
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2011

Стакан

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

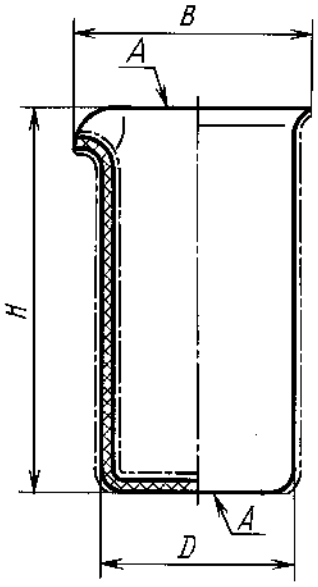

Черт. 1

Номер стакана	Код ОКП	Номинальная вместимость, см^3	D		H		B	
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
1	43 2811 0011 01	25	35	± 1	40	± 2	40	± 1
2	43 2811 0012 00	50	35		70	± 3	45	
3	43 2811 0013 10	150	50	± 2	90	± 5	65	± 2
4	43 2811 0014 09	250	60		110		75	± 3
5	43 2811 0015 08	400	75	± 3	120	± 6	90	
6	43 2811 0016 07	600	85		135		100	± 5
7	43 2811 0017 06	1000	100	± 5	170	± 10	120	
8	43 2811 0018 05	2000	125	± 6	205		145	± 6
9	43 2811 0019 04	4000	175	± 7	220		200	± 7

Пример условного обозначения стакана № 3 номинальной вместимостью 150 см^3:

Стакан 3 ГОСТ 9147—80

Выпарительная чашка

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

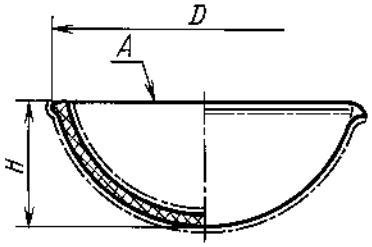

Черт. 2

Номер чашки	Код ОКП	Номинальная вместимость, см^3	D		H	
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
1	43 2812 1011 03	25	62	± 2	25	± 1
2	43 2812 1012 02	50	77		30	
3	43 2812 1013 01	100	97	± 3	35	
4	43 2812 1014 00	150	107		40	
5	43 2812 1015 10	250	123		50	± 2
6	43 2812 1016 09	450	163	± 5	55	
7	43 2812 1017 08	850	205		60	
8	43 2812 1018 07	1500	265	± 7	75	
9	43 2812 1019 06	4000	335	± 10	100	± 3

Пример условного обозначения выпарительной чашки № 3 номинальной вместимостью 100 см^3:

Чашка выпарительная 3 ГОСТ 9147—80